

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE of CONFORMITY

Зареєстровано
в реєстрі ОС та ОБ
«АКАДЕМТЕСТ»
Зареєстрован в реєстрі ОС та ОБ
«АКАДЕМТЕСТ» под № /
Registered at the Record CB and AB
"ACADEMTEST" under №

за № UA.OS-01.0025-19

Термін дії
з 26.09.2019
до 25.09.2022
Срок действия с / Term of
validity is from

Продукція

Продукция/
Production

Прилади та апаратура автоматичного регулювання або контролю для систем холодного та гарячого водопостачання, опалення, кондиціонування (згідно з додатком 115 артикулів)

9032

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(ТНВЭД, ДК-016)
(UKTZED code, DK-016)

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДСТУ EN 61000-6-1:2015 п. 1.5 табл. 1; ДСТУ EN 61000-6-3:2015 розд. 9; ДСТУ EN 60730-1:2015 розділи 6-8; ДСТУ EN 60730-2-6:2016 розділи 7-8

Виробник продукції
Изготовитель продукции
Producer

"Giacomini S.p.A.", Via per Alzo 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Італія

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued on

"Giacomini S.p.A.", Via per Alzo 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Італія

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно з 26.09.2019 до 25.09.2022. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією один раз на півтора роки.

Сертифікат видано
органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по
сертификации/Certificate issue
certification body

ОС та ОБ "АКАДЕМТЕСТ"
Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків,
вул. Весніна, буд. 5. Код ЄДРПОУ 37188889
Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 99-
А., оф.501. e-mail: akademtest@gmail.com

На підставі
На основании/
On the grounds of

Протоколу випробувань № 2019.01.09.26.01 від 26.09.2019
ВЛ ТОВ "АКАДЕМТЕСТ" (61023, м. Харків, вул. Весніна, 5).
Акту обстеження виробництва № 040Д від 19.08.2019

Керівник органу з сертифікації


Руководитель органа оценки соответствия
Director of the conformity assessment body




(Підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/
(signature, initials, family name)

Р.В. Горлов

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации,
тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment
body, тел. (057) 766-44-86



Academtest®

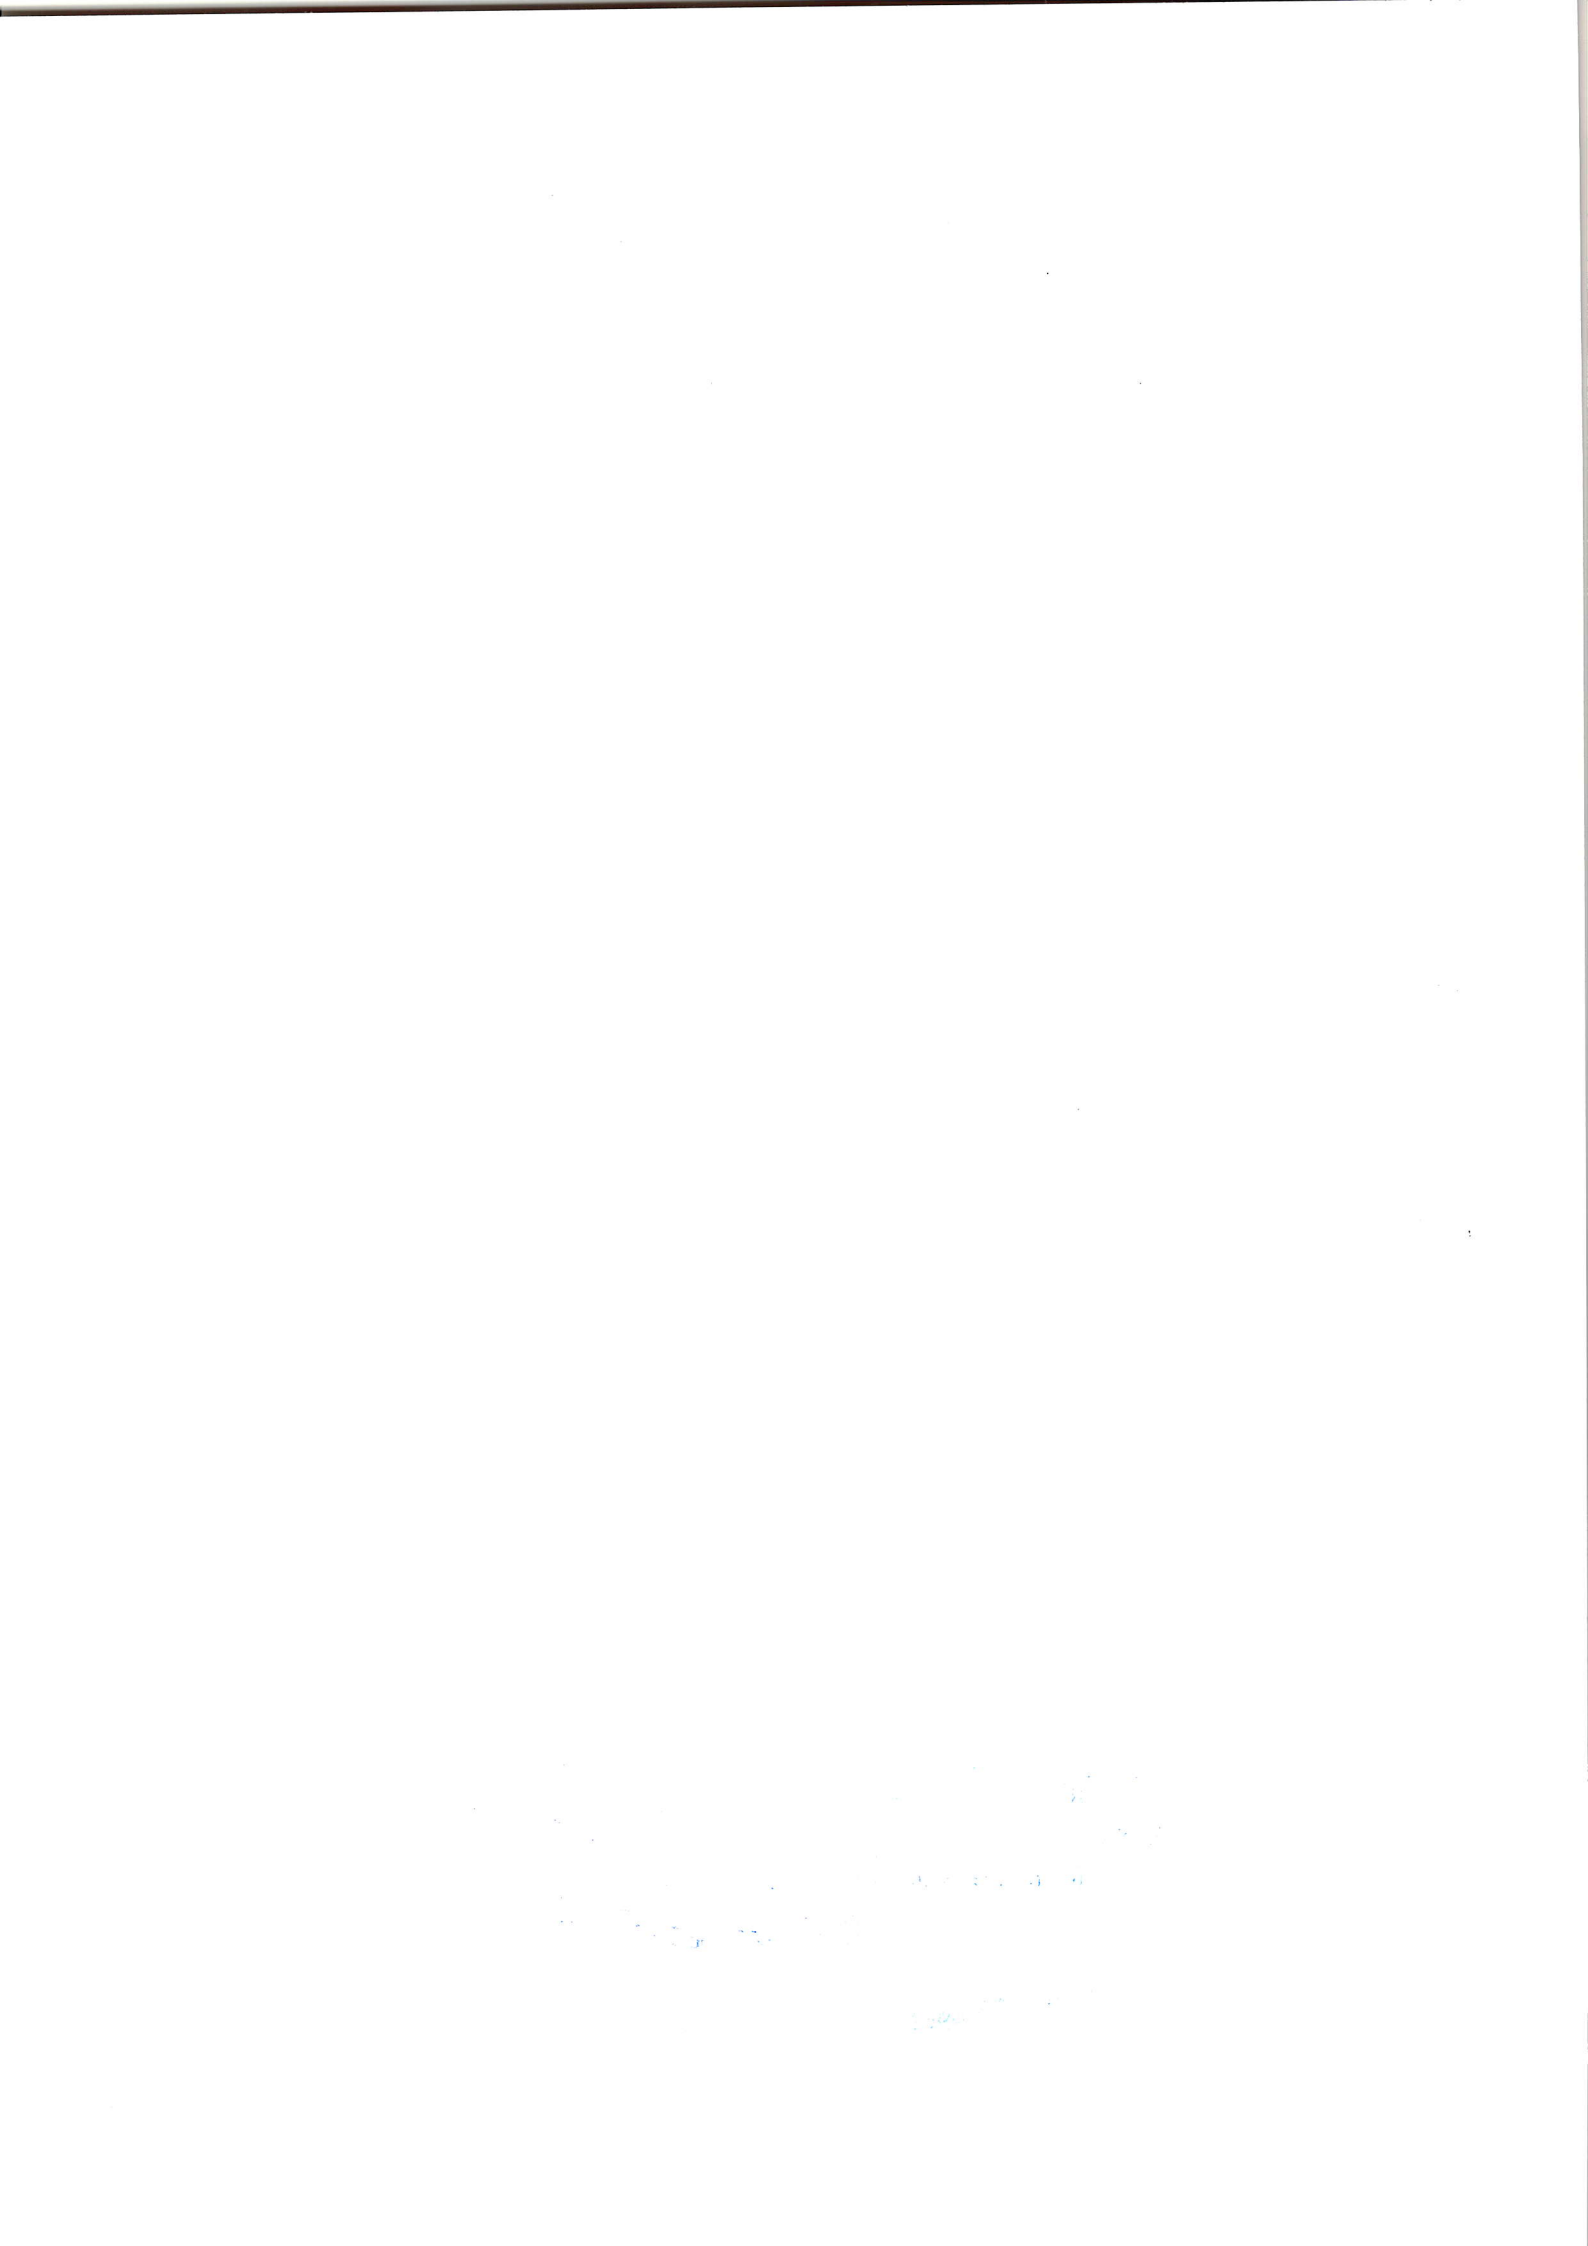

ДОДАТОК до сертифіката відповідності

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO THE CERTIFICATE of CONFORMITY

Зареєстровано
в реєстрі ОС та ОБ
«АКАДЕМТЕСТ»

Зарегистрирован в реестре ОС та ОБ
«АКАДЕМТЕСТ» под № /
Registered at the Record CB and AB
“ACADEMTEST” under №

за № UA.CC-01.0025-19

Термін дії
з 00.09.2019
до 00.09.2022
Срок действия с / Term of
validity is from

Прилади та апаратура автоматичного регулювання або контролю для систем холодного та гарячого водопостачання, опалення, кондиціонування, артикулів:

KPM20*, KPM21*, KM200*, KM201*, KM202*, KM203*, KD200*, KF200*, K481A*, K481B*, K481*, K481D*, K480I*, K480*, K482A*, K482F*, K482D*, K483*, K483B*, K483F*, K483D*, K490*, K490I*, K494I*, K494*, K499*, K492*, KPM30*, KPM31*, KPM35*, KPM36*, KPM40*, KPM45*, K497*, KD201*, K492*, K495*, K495L*, K4E3*, K465*, K498*, KDP*, KDS*, KF200*, K485*, PM100P*, PM100R*, K363P*, K365P*, K3E1A*, K363A*, K365*, K366A*, K367*, K480*, K373*, K370A*, K370B*, K370C*, K371A*, K360*, R478*, R478M*, R473*, R473M*, K274*, K280*, K281*, K282*, K274*, K270*, K272*, KM20E*, K485*, KSMSAY001, K365P*, K363P*, KTDS*, KTD5*, R586S*, KDS*, R270BY03, R270MY001, R270MY002, K500*, K374*, R206*, R150N*, K297*, K275*, K369*, K400, K410*, K463*, K465*, K470*, K471*, K493*, KA410*, KD400*, KD410*, KDP*, KDS*, KDV*, KE410*, KTDS*, KV*, GE700*, P586S*, GX200*, R225*, RP200*, GE552*, GE553*;

де замість * – можливі літери та/або цифри, що визначають комплектацію, модифікацію або наявність додаткових функцій, що не впливають на вимоги безпеки.

Загальна кількість – 115 артикулів

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа оценки соответствия
Director of the conformity assessment body




(Підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/
(signature, initials, family name)

P.V. Горлов

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сertiфікації,
тел. (057) 766-44-86

Действие сертификата соответствия можна перевірити в базі даних органу по сертификации,
тел. (057) 766-44-86

Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment
body, тел. (057) 766-44-86



Academtest®

Faint, illegible markings or text located in the lower right quadrant of the page, possibly a stamp or bleed-through.